



การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของผลการตรวจวิเคราะห์พิษของเชื้อคลอสทริเดียมดิฟฟิไซส์ เอ/บี โดยวิธีเลตเฟอรัลโฟลอิมมูโนโครมาโตกราฟี

Changes in *Clostridium difficile* Toxin A/B Detection Results Using Lateral Flow Immunochromatography

กฤษฎา ศิริสภามณณ์*, สุภาพร พุ่มพา, พลากร พุทธรักษ์


งานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี 12120

Kridsada Sirisabhabhorn*, Supaporn Pumpa, Palakorn Puttaruk

Department of Medical Technology Laboratory, Thammasat University, Pathumthani 12120

Received 7 June 2024; Received in revised 8 March 2025; Accepted 1 July 2025

GRAPHICAL ABSTRACT

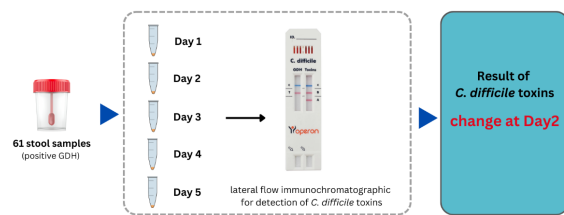

ABSTRACT

Toxin types A (TcdA) and B (TcdB) of *Clostridium* or *Clostridioides difficile* (*C. difficile*) are responsible for causing severe diarrhea in patients with CDI (*Clostridioides difficile* infection), and can lead to fatal outcomes. Detection of glutamate dehydrogenase (GDH) and TcdA/B using lateral flow immunochromatography (IC) is crucial for CDI diagnosis. However, when immediate testing is not possible, fecal samples are typically stored at 4°C until official analysis, sometimes for up to 5 days. This study aimed to determine

the critical day—the first day on which IC test results for GDH and TcdA/B begin to deviate from Day₁ results, potentially affecting clinical decision-making. A total of 61 post-analysis fecal samples from patients at Thammasat University Hospital, Pathumthani, Thailand, were divided into five aliquots per sample, stored at 4°C, and tested for GDH and TcdA/B using the IC method from Day 1 to Day 5. The agreement of test results across the 5 days was evaluated using Cohen's Kappa coefficient. The results identified Day 2 as the critical day. Overall, IC test result patterns between Day₁ and Days₂₋₅ showed high agreement (almost perfect concordance). However, beginning on Day₂, a 4.90-6.60% increase in negative results was observed, which may lead to missed diagnoses and delayed treatment. In conclusion, GDH and TcdA/B detection using the IC method should be performed as soon as possible to reduce the lethal rate.

คำสำคัญ

อิมมูโนโครมาโตกราฟี;
C. difficile; พิษ;
อุจจาระ;
การเปลี่ยนแปลง

Keywords

TcdA; TcdB;
Glutamate dehydrogenase;
Critical day

บทคัดย่อ

พิษของเชื้อ *Clostridium* หรือ *Clostridioides difficile* (*C. difficile*) ชนิด A(TcdA) และ B(TcdB) ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการท้องเสียรุนแรงขึ้นเสียชีวิตได้ การตรวจ Glutamate dehydrogenase (GDH) TcdA และ TcdB ของเชื้อด้วยวิธี Lateral flow immunochromatography (IC) หากไม่สามารถตรวจได้ทันทีต้องเก็บอุจจาระที่ 4°C เพื่อรอตรวจ บางครั้งอาจนานถึง 5 วัน (Day₁₋₅) การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาวันที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง (Critical day) ของผลตรวจ GDH, TcdA และ TcdB จากวันแรก (Day₁) โดยใช้อุจจาระหลังจากตรวจประจำวันจากผู้ป่วยของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี จำนวน 61 ตัวอย่าง โดยแบ่งอุจจาระเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4°C เพื่อทำการตรวจ GDH, TcdA และ TcdB ด้วยวิธี IC ในวันที่ 2 ถึง 5 (Day₂₋₅) จากนั้นวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลจากวิธี IC ระหว่างวัน (Day₁₋₅) ด้วย Cohen's Kappa coefficient ผลการทดลองพบว่า Critical day เท่ากับ 2 เนื่องจากเป็นวันที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของผล GDH, TcdA และ TcdB สำหรับรูปแบบการรายงานผลตรวจ (ประกอบด้วย GDH/TcdA/TcdB เรียงกัน) ของวิธี IC(Day₁ vs Day₂₋₅) ยังมีความสอดคล้องกันในระดับ Almost perfect แต่ใน Day₂₋₅ อาจปรากฏรูปแบบของผลตรวจที่ทำให้ผู้ป่วยพลาดการรักษาตั้งแต่ร้อยละ 4.90 ถึงร้อยละ 6.60 ได้ สรุปว่าการตรวจ GDH, TcdA/B ด้วยวิธี IC ควรตรวจทันทีภายใน 1 วันสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้

*ผู้รับผิดชอบบทความ: ksirisabhabhorn@gmail.com

DOI:

1. บทนำ

โรค *Clostridioides difficile* infection (CDI) เกิดจากการติดเชื้อ *C. difficile* เป็นเชื้อแบคทีเรีย แอนแอโรบ ชนิดแกรมบวก สร้างสปอร์ แพร่กระจายผ่านทาง Oral-Fecal route เชื้อ *C. difficile* ผลิต Enterotoxin ชนิด A (TcdA) และ Cytotoxin ชนิด B (TcdB) ซึ่งเป็นปัจจัยก่อให้เกิดความรุนแรงของโรค (Virulence factor) โดยยีน *tcdA* และ *tcdB* ของเชือบนตำแหน่งยีน Pathogenicity locus (PaLoc) ตามลำดับ พืชทั้ง 2 ชนิดของเชื้อทำงานร่วมกับ Pili flagella และ Mono glycosyltransferases ทำให้มีคุณสมบัติเกาะติดผิวเซลล์ของเยื่อทางเดินอาหาร เจริญเติบโต (Colonization) และทำลายเยื่อทางเดินอาหาร (Gut) [1] สำหรับอาการทางคลินิกมีตั้งแต่ท้องเสียท้องร่วง (Diarrhea) ในขั้นเริ่มต้น (Mild) ถึงขั้นรุนแรง (Severe) ส่งผลให้เสียชีวิตได้ ปรากฏอุบัติการณ์อัตราการติดเชื้อซ้ำและการเสียชีวิตของโรค CDI สูงสำหรับในประเทศไทยเกิด Recurrence rate ร้อยละ 3 นอกจากนี้โรค CDI ยังดื้อต่อยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) ซึ่งใช้ในการรักษาด้วย สำหรับในประเทศไทยพบรายงานการดื้อต่อยา Clindamycin, Erythromycin และ Moxifloxacin [2, 3] เคยมีการรายงานความสัมพันธ์เกี่ยวกับความหลากหลายของสายพันธุ์ที่สามารถผลิตพิษของเชื้อกับความรุนแรงของโรคและการดื้อต่อยาต้านหลายฉบับ [4, 5, 6] ดังนั้นการตรวจวิเคราะห์ชนิดของพิษของเชื้ออย่างถูกต้องจึงมีความสำคัญอาจช่วยบ่งบอกถึงสายพันธุ์ของเชื้อและเป็นประโยชน์ต่อการรักษาได้

แม้ว่าการตรวจหาเอนไซม์ Glutamate dehydrogenase (GDH) ของเชื้อและการจำแนกชนิดพิษของเชื้อ *C. difficile* ด้วยวิธี IC (Lateral flow immunochromatography) สามารถทำได้ง่าย สะดวก และรายงานผลได้รวดเร็วแต่หากไม่สามารถทำได้ทันทีเนื่องจากข้อจำกัดบางประการของห้องปฏิบัติการจึงต้องทำการเก็บอุจจาระในสภาวะที่เหมาะสมเพื่อรอตรวจวิเคราะห์ เคยมีรายงานการศึกษาที่เกี่ยวกับการเก็บ

อุจจาระตามเงื่อนไขของอุณหภูมิตามระยะเวลาและวิธีการตรวจวิเคราะห์ทำให้ผลการตรวจพบ TcdA และ TcdB มีความแตกต่างกัน เช่น Becker, S.L. et al. รายงานว่าอุจจาระที่เก็บ 4 องศาเซลเซียส ($^{\circ}\text{C}$) ภายใน 28 วัน ยังสามารถตรวจพบ GDH และ Toxin ได้ด้วยวิธี PCR [7] Schora, D.M. et al. รายงานว่าอุจจาระที่เก็บ 4°C ภายใน 120 วันยังสามารถตรวจพบ Toxin ของเชื้อด้วยวิธี EIA [8] เช่นเดียวกับ Nho, S.W. et al. รายงานว่าอุจจาระที่เก็บ 4°C ภายใน 60 วัน ยังคงตรวจพบ Toxin ของเชื้อด้วยวิธี Toxigenic culture ได้ [9] ในขณะที่ Borriello et al. รายงานว่าไม่สามารถตรวจพบ TcdA ได้หากเก็บอุจจาระที่เก็บ 4°C ถึง 52 วัน [10] Bowman, R.A. and Riley, T.V. รายงานการลดลงของปริมาณสารพิษในอาหารเลี้ยงเชื้อภายใน 2 วันโดยเก็บไว้ ณ อุณหภูมิที่ 5°C [11] แม้ว่าวิธี Cytotoxic culture เป็นวิธี Gold standard ของการตรวจวิเคราะห์เชื้อและพิษของเชื้อ *C. difficile* แต่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ทักษะประสบการณ์ที่ชำนาญ ต้องใช้ห้องปฏิบัติการเฉพาะราคาสูงและใช้ระยะเวลานานประมาณ 2-3 วัน ดังนั้นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ส่วนใหญ่จึงนิยมใช้การตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Enzyme immunoassays (EIA) หรือ Immunochromatography (IC) แต่ยังมีกรรายงานผลช่วงความแตกต่างของความไวและความจำเพาะมาก [12]

สำหรับงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (รพธ.) จ.ปทุมธานี ได้กำหนดการตรวจวิเคราะห์ GDH, TcdA และ TcdB ด้วยวิธี IC ในวันและเวลาราชการเนื่องจากข้อจำกัดบางประการของห้องปฏิบัติการบางครั้งหากมีวันหยุดราชการยาวนานประมาณ 5-7 วัน จึงจำเป็นต้องเก็บอุจจาระไว้ที่ 4°C เพื่อรอตรวจ จากการสังเกตพบว่าหลังช่วงวันหยุดยาวพบผลตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวส่วนใหญ่ให้ผลเป็นลบ (Negative) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับระยะเวลาของการเก็บอุจจาระเพื่อรอตรวจจะทำให้ผลการตรวจวิเคราะห์ GDH, TcdA

และ TcdB ด้วยวิธี IC มีการเปลี่ยนแปลงจากวันแรก (Day₁) หรือไม่ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ค้นหาวันที่ผลตรวจ GDH, TcdA และ TcdB ด้วยวิธี IC เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง (Critical day) ไปจากวันแรกของการตรวจ เมื่อเก็บอุจจาระที่อุณหภูมิ 4°C ภายในระยะเวลา 1 ถึง 5 วัน (Day₁₋₅) และศึกษาผลกระทบจากรูปแบบการรายงานผลตรวจที่มีการเปลี่ยนแปลง

2. อุปกรณ์และวิธีการ

2.1 กลุ่มตัวอย่าง

คัดเลือกตัวอย่างอุจจาระหลังการตรวจวิเคราะห์ GDH, TcdA และ TcdB ด้วยวิธี IC จากผู้ป่วยของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (รพธ.) จ.ปทุมธานี จำนวน 61 ราย โดยคัดเลือกอุจจาระที่ให้ผล GDH positive จากวิธี IC (Day₁; reference) และไม่พบพบเชื้อในกลุ่ม Gastroenteroparasitic infection จากนั้นแบ่งอุจจาระแต่ละตัวอย่างใส่ Aliquot tube จำนวน 4 หลอด เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4°C เพื่อรอตรวจวิเคราะห์ GDH, TcdA และ TcdB ด้วยวิธี IC ในวันที่ 2 ถึง 5 (Day₂₋₅) ของการทดลองต่อไป

2.2 ตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Lateral flow immunochromatography (IC)

ใช้ตัวอย่างอุจจาระปริมาณ 110 มิลลิกรัมหรือ 110 ไมโครลิตร ลงใน Sample tube ที่ภายในมี Buffer บรรจุอยู่ จากนั้นเขย่าให้เป็นเนื้อเดียวกัน (Homogenous) หยดลงใน Sample wells (GDH และ TcdA/TcdB Wells) ของ Strip ตามลำดับ อ่านผลการทดสอบภายในเวลา 20 นาที หากในอุจจาระมี GDH, Toxin A หรือ B จะปรากฏเป็นเส้นสีแดงบริเวณ Test line อ่านผลเป็นบวก หมายถึง มีเอนไซม์ GDH และมีพิษชนิด A/B ของเชื้อ *C. difficile* ในอุจจาระตามลำดับ [13] (Figure 1)

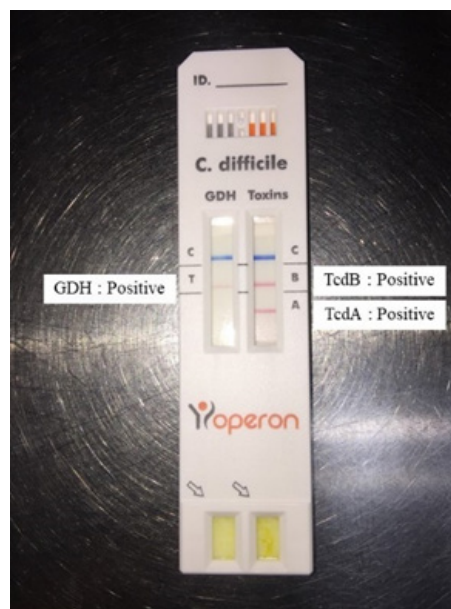


Figure 1 The positive results of GDH, TcdA, and TcdB by IC method.

2.3 จริยธรรมการวิจัยและความปลอดภัยทางชีวภาพ

งานวิจัยนี้ได้ขออนุญาตดำเนินการวิจัยและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติหมายเลข 014/2565 และคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมายเลข 078/2565

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

ค้นหาวันที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง (Critical day) ของผลการทดสอบ GDH, TcdA และ TcdB โดยสังเกตจากวันที่ผลการตรวจด้วยวิธี IC จากวันที่ 2 ถึง 5 เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปจากวันแรก (Day₁) คำนวณร้อยละของการเกิดผลบวก (Positive) และผลลบ (Negative) จาก

$$\frac{\text{จำนวนตัวอย่างของการเกิดผลบวก (Positive) หรือผลลบ (Negative)}}{\text{จำนวนตัวอย่างทั้งหมด (N=61)}} \times 100$$

จากนั้นวิเคราะห์และแปลผลค่าความสอดคล้องของผลตรวจแต่ละชนิดของ GDH, TcdA และ TcdB และความสอดคล้องของรูปแบบการรายงานผล (ประกอบ

ด้วย GDH/TcdA/TcdB เรียงกัน) จากวิธี IC ภายใน 5 วัน (Day₁-Day₅) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ Cohen's Kappa ด้วยโปรแกรม SPSS® (Table 1)

Table 1 The interpretation of agreement analysis by Cohen's Kappa coefficient [14]

Values of Kappa	Levels of agreement	% Reliable
0.00-0.20	None	0-4%
0.21-0.39	Minimal	4-15%
0.40-0.59	Weak	15-35%
0.60-0.79	Moderate	35-63%
0.80-0.90	Strong	64-81%
> 0.90	Almost perfect	82-100%

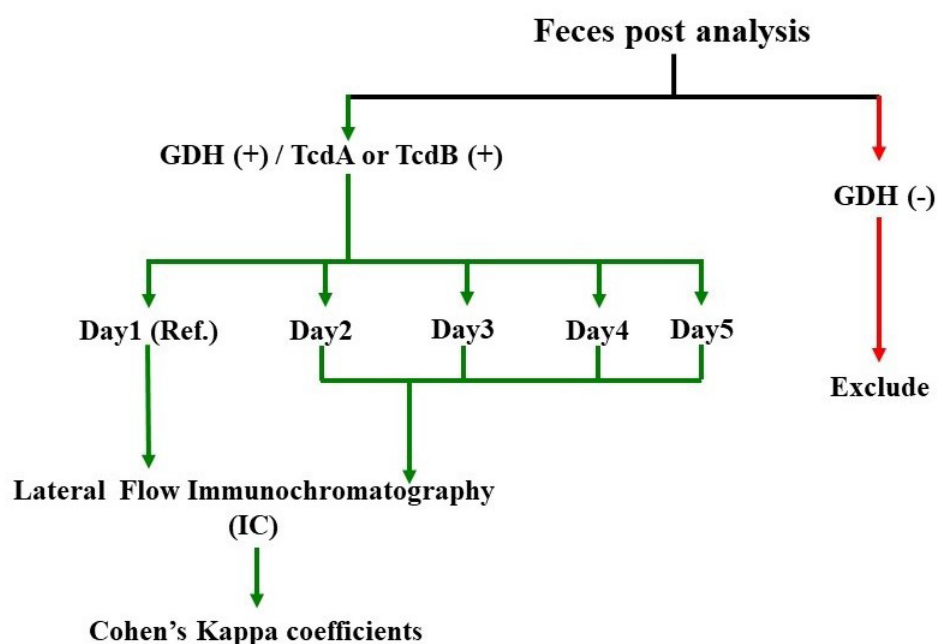


Figure 2 Flowchart of research method

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์

3.1 การเปลี่ยนแปลงผลตรวจวิเคราะห์ GDH, TcdA และ TcdB ของวิธี IC ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 5 ของการทดลอง (Day₁₋₅)

จากการทดลองพบว่าผลการตรวจวิเคราะห์ GDH, TcdA และ TcdB ด้วยวิธี IC เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในวันที่ 2 (Day₂) ซึ่งแสดงผลของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดัง Table 2 and Figure 3 ตามลำดับดังนี้

จากผลการทดลอง Table 2 and Figure 3 พบว่าผลบวก GDH เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากผลบวกเป็นผลลบจำนวน 4 ราย (ตัวอย่าง No. 30, 36, 51, 52 (ไม่ได้แสดง)) คิดเป็นร้อยละ 6.56 และเปลี่ยนไปเป็นผลลบอีก 1 รายในวันที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 1.64 และปรากฏผล GDH บวกคงที่ 56 รายคิดเป็นร้อยละ 91.80 ในวันที่ 3-5 ของการทดลอง โดยรวมผล GDH มีการเปลี่ยนแปลงจากผลเริ่มต้น (Day₁) มากที่สุดร้อยละ 8.20 หรือจำนวน 5 ราย เคยมีรายงานการศึกษาผลของการ Freeze throw หลายครั้งพบว่าทำให้การตรวจจับ GDH

Table 2 The results of Immunochromatography (IC) from Day₁ to Day₅ of the experiment.

Days	Results N=61	GDH n (%)	TcdA n (%)	TcdB n (%)
1(ref.)	Negative	0(0.00)	53(86.89)	51(83.61)
	Positive	59(96.72)	8(13.11)	8(13.11)
	Weakly positive	2(3.28)	0(0.00)	2(3.28)
2	Negative	4(6.56)	52(85.25)	50(81.97)
	Positive	55(90.16)	8(13.11)	10(16.39)
	Weakly positive	2(3.28)	1(1.64)	1(1.64)
3	Negative	5(8.20)	53(86.89)	50(81.97)
	Positive	56(91.80)	8(13.11)	9(14.75)
	Weakly positive	0(0.00)	0(0.00)	2(3.28)
4	Negative	5(8.20)	53(86.89)	49(80.33)
	Positive	55(90.16)	7(11.48)	10(16.39)
	Weakly positive	1(1.64)	1(1.64)	2(3.28)
5	Negative	5(8.20)	53(86.89)	50(81.97)
	Positive	55(90.16)	8(13.11)	10(16.39)
	Weakly positive	1(1.64)	0(0.00)	1(1.64)

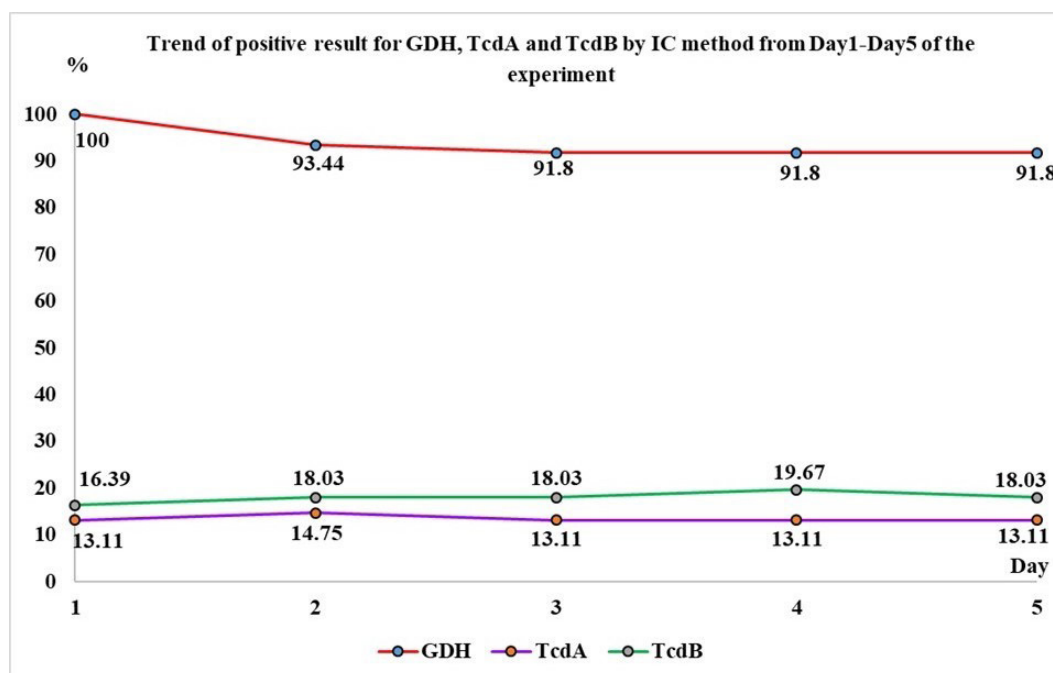


Figure 3 The trend of positive results for GDH, TcdA, and TcdB by IC method during Day₁₋₅ of the experiment

ผลบวกลดลง [15, 16] และอาจลดลงได้มากถึงร้อยละ 3.70 ถึงร้อยละ 11.10 [17] บางครั้งความเย็นอาจมีผลต่อผลบวกของ GDH ที่ลดลงได้ ดังนั้นการเก็บอุจจาระเพื่อรอการตรวจวิเคราะห์ที่ 4°C อาจทำให้ Activity ของเอนไซม์ GDH ลดลง จึงสังเกตการปรากฏผลบวกของ GDH ในวันที่ 2 หรืออาจปรากฏผลเป็นผลบวกจาง (Weakly positive) ในวันถัดไปเพิ่มขึ้น ในขณะที่การอ่านผลของ TcdA และ TcdB มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเท่ากับร้อยละ 1.64 และร้อยละ 3.28 ตามลำดับ โดยผลการตรวจวิเคราะห์ TcdA พบเพิ่มขึ้น 1 ราย (ตัวอย่าง No. 26 (ไม่ได้แสดง)) คิดเป็นร้อยละ 1.64 ในวันที่ 2 และปรากฏผลบวกลดลง 1 รายทำให้ผล TcdA บวกคงที่ 8 รายคิดเป็นร้อยละ 13.11 ตั้งแต่วันที่ 3-5 ของการทดลอง ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของผลบวก TcdB มีการเปลี่ยนแปลงเป็นผลบวกจำนวน 1 ราย (ตัวอย่าง No. 27 (ไม่ได้แสดง)) คิดเป็นร้อยละ 1.64 และเปลี่ยนเป็นผลบวกอีก 1 รายคิดเป็นร้อยละ 1.64 ในวันที่ 2 และ 4 ของการทดลองและเปลี่ยนเป็นผลลบ 1 รายคิดเป็นร้อยละ 1.64

ในวันที่ 5 ของการทดลองตามลำดับ ทำให้ TcdB มีช่วงการเปลี่ยนแปลงมากกว่าอยู่ที่ร้อยละ 3.20 อาจเป็นเพราะความคงตัวของ Toxin A มีมากกว่า Toxin B จึงทำให้พบการเปลี่ยนแปลงของผล Toxin B มีมากกว่า [18] ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ จากการศึกษารายงานว่า Grześkowiak et al. รายงานว่าการตรวจจับ TcdA ที่ 4°C ลดลงจากวันที่ 1, 2, 7, 14 และ 21 อย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่มีผลต่อการตรวจจับ TcdB [19] Aichinger, E. et al. รายงานว่าจากการทดสอบซ้ำภายใน 7 วันของวิธีทาง Immunoassay (EIA) พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงจากลบเป็นบวกในอัตราที่ต่ำมากประมาณร้อยละ 1.90 [20] และพบการคงผลบวกของ Toxin A/B อยู่ที่ร้อยละ 10.60 ภายใน 7-10 วัน แต่ไม่แนะนำให้มีการทดสอบซ้ำในตัวอย่างอุจจาระที่ให้ผลลบเกิน 2 วันเนื่องจากพบว่าผลสามารถเปลี่ยนเป็นผลบวกได้ [21] ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ ดังนั้นหากทำการทดสอบด้วยวิธี IC ควรทำการทดสอบในวันแรก (Day₁) เนื่องจากหากเก็บอุจจาระเพื่อรอการตรวจวิเคราะห์ผลอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ และ Barbut, F. et al. รายงานว่าควรตรวจ TcdA และ TcdB ทันทีภายในวันที่มีการเก็บอุจจาระจากผู้ป่วย [22] แต่หากไม่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ภายในวันนั้นให้เก็บที่อุณหภูมิ 4°C ไม่เกิน 72 ชั่วโมงหรือเก็บที่อุณหภูมิ -80°C แต่ไม่แนะนำให้เก็บที่อุณหภูมิ -20°C เนื่องจากผลึกของน้ำแข็ง (Ice crystal) อาจไปทำลายโครงสร้างโปรตีนของสารพิษของเชื้อทำให้ตรวจพบได้ลดลง [23, 24] สำหรับการศึกษาครั้งนี้แสดงผล Critical day ของการตรวจวิเคราะห์ GDH, TcdA และ TcdB ของการรายงานผลด้วยวิธี IC คือ Day₂

สำหรับการลดลงและเพิ่มขึ้นของการพบ Toxin A และ Toxin B ของวิธี IC ในช่วง Day₁-Day₅ นั้น อาจเกิดจากหลายปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เกิดจากความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการทดสอบ การอ่านผลและแปลผลด้วยด้วยสายตาหรือการประมาณ Toxin ของเชื้อในอุจจาระที่น้อยในบางตัวอย่างตั้งแต่เริ่มต้น

3.2 การทดสอบความสอดคล้องของผลตรวจวิเคราะห์และรูปแบบการรายงานผลตรวจวิเคราะห์ GDH, TcdA และ TcdB ของวิธี IC ในระหว่างวันที่ 1-5 ของการทดลอง (Day₁₋₅) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ Cohen's Kappa

จากผลการทดลองเมื่อเก็บอุจจาระเพื่อรอตรวจในวันที่ 2 ถึง 5 ปรากฏว่าผลการตรวจ GDH, TcdA และ TcdB และ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากวันที่ 1 หากนำผลตรวจมารวมกันเพื่อรายงานแพทย์จะทำให้เกิดรูปแบบการรายงานผล (Result pattern: GDH/TcdA/TcdB) ที่แตกต่างกันซึ่งอาจกลายเป็นรูปแบบผลตรวจที่ไม่บ่งบอกถึงความรุนแรงทางคลินิกได้และอาจทำให้ผู้ป่วยไม่ได้เข้ารับการรักษาได้ซึ่งหากผลตรวจด้วยวิธี IC ส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยมากจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจและการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการต่อไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ศึกษาความสอดคล้องของผลการตรวจแต่ละชนิดของ GDH, TcdA และ TcdB และความ

สอดคล้องของรูปแบบการรายงานผลของวิธี IC ในวันที่ 1-5 (Day₁₋₅) จึงได้ทำการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง Cohen's Kappa ดังนี้

จาก Table 3 (3A-3C) แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าผลตรวจวิเคราะห์ GDH, TcdA และ TcdB ของวิธี IC มีการเปลี่ยนแปลงแต่ผลตรวจวิเคราะห์ในระหว่าง 5 วันของการทดลองยังคงมีความสอดคล้องกันในระดับสูงมาก Almost perfect (Kappa = 0.951-1.00) (Table 1) อย่างไรก็ตามการรายงานผลตรวจวิเคราะห์พิษของเชื้อ *C. difficile* ของงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (รพธ.) ต้องรายงานผล GDH, TcdA และ TcdB ด้วยวิธี IC ประกอบกันเรียงตามลำดับเช่น GDH ผลบวก, TcdA ผลลบ และ TcdB ผลบวก รายงานเป็น GDH⁺/TcdA⁻/TcdB⁺ เป็นต้น ซึ่งหากผลการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี IC มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 5 วันของการทดสอบจะทำให้เกิดรูปแบบการรายงานผลที่แตกต่างกันในผู้ป่วยคนเดียวกัน ผู้วิจัยมีความประสงค์ศึกษารูปแบบการรายงานผลแก่แพทย์ที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการเข้ารับการรักษของผู้ป่วยอย่างไร จึงได้ทำการออกแบบรูปแบบการรายงานผลโดยให้อักษร “P” แทนค่าเป็นผลบวก (Positive) และผลบวกจาง (Weakly positive) และอักษร “N” แทนค่าเป็นผลลบ (Negative) ใส่แทนค่าการรายงานผลเรียงตามลำดับ GDH, TcdA และ TcdB ซึ่งรูปแบบการรายงานผลแบบ NNN (GDH⁺/TcdA⁻/TcdB⁺) อาจทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาเนื่องจากผลตรวจวิเคราะห์ทั้งหมดเป็นผลลบ

จาก Figure 4 แสดงข้อมูลการกระจายตัวของรูปแบบการรายงานผลตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี IC ทั้ง 7 รูปแบบของแต่ละวันที่ 1-5 (IC(Day₁₋₅)) โดยแสดงเป็นค่า % (n) (4A) เมื่อพิจารณาจาก Graph (4B) ปรากฏว่ารูปแบบการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ GDH/TcdA/TcdB ด้วยวิธี IC ในแต่ละ Patterns ตั้งแต่วันที่ 1-5 (Day₁₋₅) ของการทดลองมีค่ามัธยฐาน (median) ไม่ต่าง

Table 3 The Cohen's Kappa coefficient values in agreement analysis of IC method crossing Day₁ to Day₅ for GDH (3A), TcdA (3B), and TcdB (3C), respectively.

3A

IC method	GDH (day ₁)	GDH (day ₂)	GDH (day ₃)	GDH (day ₄)	GDH (day ₅)
GDH (day ₁)		0.961	0.951	0.951	0.951
GDH (day ₂)			0.99	0.99	0.99
GDH (day ₃)				1	1
GDH (day ₄)					1
GDH (day ₅)					

3B

IC method	TcdA(day ₁)	TcdA(day ₂)	TcdA(day ₃)	TcdA(day ₄)	TcdA(day ₅)
TcdA(day ₁)		0.99	0.981	1	0.981
TcdA(day ₂)			0.99	0.99	0.99
TcdA(day ₃)				0.981	1
TcdA(day ₄)					0.981
TcdA(day ₅)					

3C

IC method	TcdB(day ₁)	TcdB(day ₂)	TcdB(day ₃)	TcdB(day ₄)	TcdB(day ₅)
TcdB(day ₁)		0.99	0.99	0.981	0.99
TcdB(day ₂)			1	0.99	0.981
TcdB(day ₃)				0.99	0.981
TcdB(day ₄)					0.971
TcdB(day ₅)					

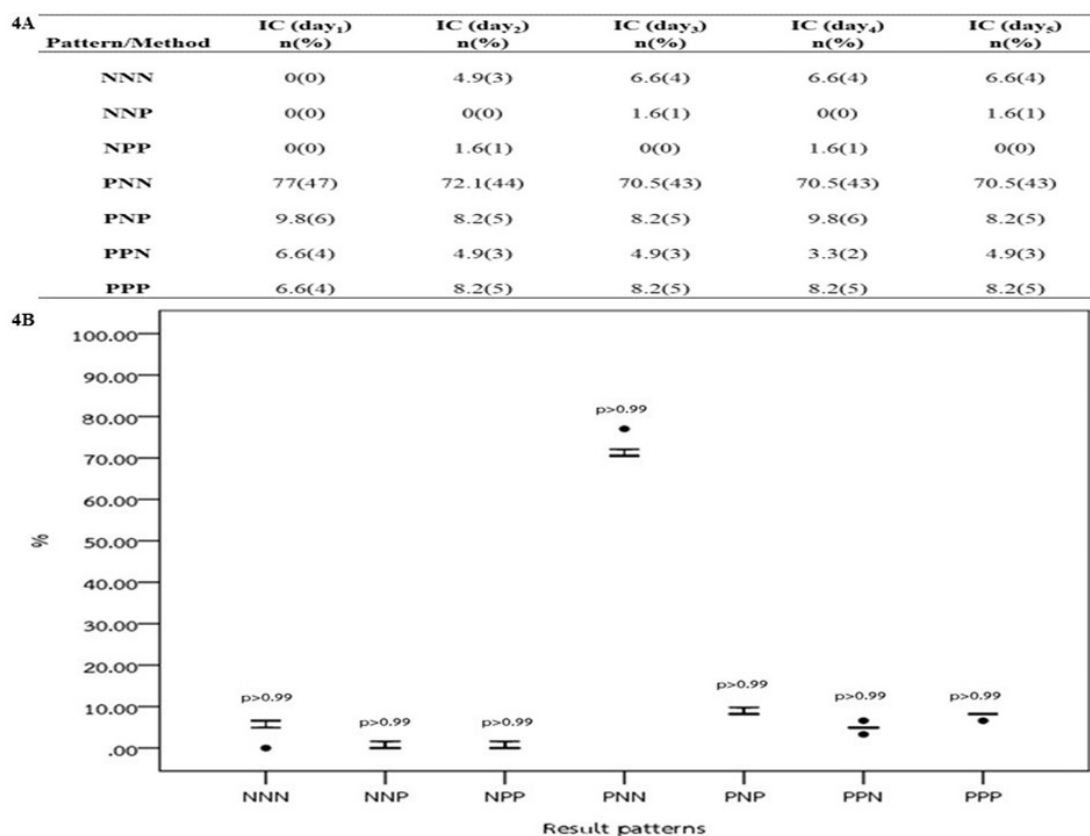


Figure 4 The frequency of distribution patterns for *C. difficile* toxin results by IC method (4A) and comparative median values during 5 days (Day₁₋₅) of 7 result patterns (NNN, NNP, NPP, PNN, PNP, PPN, and PPP) (4B) by Kruskal Wallis testing

กัน ($p > 0.05$) จากการทดสอบ Kruskal Wallis โดยแสดงค่า % Median (95%CI) ของรูปแบบผล NNN, NNP, NPP, PNN, PNP, PPN และ PPP เท่ากับ 6.60 (1.39-8.49), 0.00 (-0.45-1.73), 0.00 (-0.45-1.73), 70.50 (68.63-75.61), 8.20 (7.75-9.93), 4.90 (3.47-6.37) และ 8.20 (6.99-8.77) ตามลำดับ แม้ว่าการกระจายตัวของรูปแบบการรายงานผลแต่ละชนิดในช่วง 1-5 วัน (Day₁₋₅) ของการทดลองไม่แตกต่างกันแต่ในวันที่ 2 (Day₂) พบการเปลี่ยนแปลงผล GDH⁺ ไปเป็น GDH⁻ ทำให้เกิดรูปแบบผล NNN เป็นร้อยละ 4.90 และร้อยละ 6.60 ในวันที่ 5 (Day₅) ของการทดลอง (4A) ผู้วิจัยมีความ

ประสงค์ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการรายงานผลที่เกิดขึ้นช่วง 2-5 วัน (Day₂₋₅) ของการทดลองยังคงมีความสอดคล้องกับรูปแบบการรายงานผลของวันแรก (Day₁) ที่ได้รายงานแก่แพทย์หรือไม่ ผู้วิจัยจึงทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์ Cohen's Kappa และแสดงผลการวิเคราะห์ดังนี้

แม้ว่าผลการตรวจวิเคราะห์ GDH/TcdA/TcdB จะมีการเปลี่ยนแปลงภายในวันที่ 2-5 (IC(day₂₋₅)) แต่รูปแบบการรายงานผลยังคงไม่แตกต่างจากวันแรก (Day₁) (Kappa = 0.934) ของการตรวจ โดยแสดงให้เห็นว่าค่าวิเคราะห์ความสอดคล้องกันของผลการตรวจด้วยวิธี IC

Table 4 The Cohen's Kappa coefficient of result patterns crossing within IC method from Day₁ to Day₅ in the experiment.

Pattern/IC method	IC (day ₁)	IC (day ₂)	IC(day ₃)	IC (day ₄)	IC(day ₅)
IC (day ₁)		0.943	0.934	0.934	0.934
IC (day ₂)			0.981	0.972	0.962
IC (day ₃)				0.972	0.981
IC (day ₄)					0.953
IC (day ₅)					

ภายในวันที่ 1 ถึง 5 ของการทดลอง (IC (day₁₋₅)) (Table 5) อยู่ในระดับ Almost perfect (Kappa = 0.934-0.981) (Table 1) อย่างไรก็ตามหากเก็บอุจจาระเพื่อรอการตรวจด้วยวิธี IC ต่อไปจะส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 4.90 ในวันที่ 2 (Day₂) และเพิ่มขึ้นอีกถึงร้อยละ 6.60 ในวันที่ 5 (Day₅) แสดงให้เห็นว่าหากเก็บอุจจาระไว้ที่ 4 °C เพื่อรอการตรวจในวันที่ 2 ถึง 5 ส่งผลให้ผู้ป่วยมีโอกาสอาจพลาดการได้รับการรักษาประมาณร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 6 อย่างไรก็ตามเคยมีการศึกษาในอดีตรายงานว่าวิธีการตรวจด้วยวิธี EIA มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรค (Severe outcome) [25] แต่ยังมีข้อมูลน้อยสำหรับวิธี IC ซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจในการศึกษาประโยชน์ของการตรวจด้วยวิธี IC การรักษาและความรุนแรงทางคลินิกของโรค CDI ต่อไปในอนาคต

4. สรุป

จากการศึกษานี้พบว่า Critical day เท่ากับ 2 แนะนำควรตรวจอุจจาระด้วยวิธี IC ภายใน 1 วัน เนื่องจากการเก็บอุจจาระที่ 4°C เพื่อรอตรวจวิเคราะห์นานเกิน 1 วันจะทำให้ผลการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี IC เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปจากวันแรก (Day₁) เพราะอาจ

มีหลายปัจจัยเช่นการสลายตัวของสารพิษ ปัจจัยทางชีวภาพของเชื้อในสภาวะอุณหภูมิที่ลดลงส่งผลให้เกิดรูปแบบของผลการตรวจวิเคราะห์ที่บ่งชี้ถึงความรุนแรงของโรคลดลงอาจทำให้ผู้ป่วยพลาดโอกาสเข้ารับการรักษาสําหรับการตรวจด้วยวิธี IC ทันทีภายในวันแรกอาจช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ งานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ด้านการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สามารถใช้เป็นแนวทางกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อสิ่งส่งตรวจเพื่อให้ความเหมาะสมและยอมรับได้กับศักยภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีปัจจัยและเงื่อนไขจำกัด

5. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ ดร.ทนพ.อนุรักษ์ เชื้อมั่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ที่ช่วยให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการและโครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2565

ขอยืนยันว่าการศึกษาไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียใดๆ

6. References

- [1] Janoir, C., 2016, Virulence factors of *Clostridium difficile* and their role during infection, *Anaerobe*. 37: 13-24.
- [2] Putsathit, P., Maneerattanaporn, M., Piewngam, P., Knight, D. R. and Riley, T. V., 2017, Antimicrobial susceptibility of *Clostridium difficile* isolated in Thailand, *Antimicrob. Resist. Infect. Control*. 6: 1-6.
- [3] Imwattana, K., Putsathit, P., Leepattarakit, T., Kiratisin, P. and Riley, T. V., 2020, Mild or malign: clinical characteristics and outcomes of *Clostridium difficile* infection in Thailand, *J. Clin. Microbiol.* 58(9): 1217-1220.
- [4] Imwattana, K., Wangroongsarb, P. and Riley, T. V., 2019, High prevalence and diversity of *tcdA*-negative and *tcdB*-positive and non-toxigenic *Clostridium difficile* in Thailand, *Anaerobe*. 57: 4-10.
- [5] Imwattana, K., Knight, D. R., Kullin, B., Collins, D. A., and Riley, T. V., 2019, *Clostridium difficile* ribotype 017 - characterization evolution and epidemiology of the dominant strain in Asia, *Emerg. Microbes. Infect.* 8: 796-807.
- [6] Sholeh, M., Kouhsari, E., Talebi, M., Hallajzadeh, M. and Amirmozafari, N., 2021, Toxin gene profiles and antimicrobial resistance of *Clostridioides difficile* infection: a single tertiary care center study in Iran, *Iran. J. Microbiol.* 13(6): 793-800.
- [7] Becker, S. L., Chatigre, J. K., Coulibaly, J. T., Mertens, P. and von Müller, L., 2015, Molecular and culture-based diagnosis of *Clostridium difficile* isolates from Côte d'Ivoire after prolonged storage at disrupted cold chain conditions, *Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg.* 109(10): 660-668.
- [8] Schora, D. M., Peterson, L. R. and Usacheva, E. A., 2018, Immunological stability of *Clostridium difficile* toxins in clinical specimens, *Infect. Control. Hosp. Epidemiol.* 39(4): 434-438.
- [9] Nho, S. W., Kim, M., Kim, S. J., Foley, S. L. and Cerniglia, C. E., 2021, Pragmatic strategy for fecal specimen storage and the corresponding test methods for *Clostridioides difficile* diagnosis, *Pathogens*. 10(8): 1-13.
- [10] Borriello, S. P., Vale, T., Brazier, J. S., Hyde, S. and Chippeck, E., 1992, Evaluation of a commercial enzyme immunoassay kit for the detection of *Clostridium difficile* toxin A, *Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis.* 11(4): 360-363.
- [11] Bowman, R. A. and Riley, T. V., 1986, Isolation of *Clostridium difficile* from stored specimens and comparative susceptibility of various tissue culture cell lines to cytotoxin, *FEMS. Microbiol. Lett.* 34: 31-35.
- [12] Planche, T., Aghaizu, A., Holliman, R., Riley, P. and Krishna, S., 2008, Diagnosis of *Clostridium difficile* infection by toxin detection kits: A systematic review, *Lancet. Infect. Dis.* 8(12): 777-784.

- [13] Operon Immune and Molecular Diagnostics, 2025, Simple GDH-Toxins, Available Source: https://www.operondx.com/wp-content/uploads/pdf/instructions/0905144_GDH-Toxins_web.pdf, February 21, 2025.
- [14] McHugh, M. L., 2012, Interrater reliability: The kappa statistic, *Biochem. Med.* 22(3): 276-282.
- [15] Kvach, E. J., Ferguson, D., Riska, P. F. and Landry, M. L., 2010, Comparison of BD GeneOhm *C. diff* real-time pcr assay with a two-step algorithm and a toxin A/B enzyme-linked immunosorbent assay for diagnosis of toxigenic *Clostridium difficile* infection, *J. Clin. Microbiol.* 48: 109-114.
- [16] Novak-Weekley, S. M., Marlowe, E. M., Miller, J. M., Cumpio, J. and Weissfeld, A., 2010, *Clostridium difficile* testing in the clinical laboratory by use of multiple testing algorithms, *J. Clin. Microbiol.* 48(3): 889-893.
- [17] Sharp, S. E., Ruden, L. O., Pohl, J. C., Hatcher, P. A. and Ivie, W. M., 2010, Evaluation of the *C.Diff* quik chek complete assay, a new glutamate dehydrogenase and A/B toxin combination lateral flow assay for use in rapid, simple diagnosis of *Clostridium difficile* disease, *J. Clin. Microbiol.* 48(6): 2082-2086.
- [18] Alcalá L., 2013, Laboratory tests for diagnosis of *Clostridium difficile* infection: past, present, and future, *Enferm. Infecc. Microbiol. Clin.* 31(2): 65-67.
- [19] Grześkowiak, Ł., Riedmüller, J., Vahjen, W. and Zentek, J., 2020, Storage procedures and time influence the detectability of *Clostridium difficile* toxin A but not toxin B in porcine fecal specimens, *J. Vet. Diagn. Invest.* 32(2): 222-225. Top of Form
- [20] Aichinger, E., Schleck, C. D., Harmsen, W. S., Nyre, L. M. and Patel, R., 2008, Nonutility of repeat laboratory testing for detection of *Clostridium difficile* by use of pcr or enzyme immunoassay, *J. clin. Microbiol.* 46(11): 3795-3797.
- [21] Cardona, D. M. and Rand, K. H., 2008, Evaluation of repeat *Clostridium difficile* enzyme immunoassay testing, *J. Clin. Microbiol.* 46(11): 3686-3689.
- [22] Barbut, F., Surgers, L., Eckert, C., Visseaux, B. and Lalande, V., 2014, Does a rapid diagnosis of *Clostridium difficile* infection impact on quality of patient management?, *Clin. Microbiol. Infect.* 20(2): 136-144.
- [23] Freeman, J. and Wilcox, M. H., 2003, The effects of storage conditions on viability of *Clostridium difficile* vegetative cells and spores and toxin activity in human faeces, *J. Clin. Pathol.* 56(2): 126-128.
- [24] Barbut, F., Beauverie, L., Delas, N., Fossati-Marchal, S. and Petit, J. C., 1999, Comparative value of colonic biopsy and intraluminal fluid culture for diagnosis of bacterial acute colitis in immunocompetent patients. infectious colitis study group, *Clin. Microbiol. Infect.* 29(2): 356-360.

- [25] Planche, T. D., Davies, K. A., Coen, P. G., Finney, J. M. and Wilcox, M. H., 2013, Differences in outcome according to *Clostridium difficile* testing method: a prospective multicentre diagnostic validation study of *C difficile* infection, Lancet. Infect. Dis. 13(11): 936-945.